

هل تحتاج إلى المساعدة؟

للمزيد من المعلومات، توجه إلى الرابط التالي

www.diabetes.ascensia.com

جهاز القياس الخاص بك مسبق الضبط ومقفول لعرض النتائج بوحدة ملليمول / لتر. إذا كانت نتيجتك بوحدة ملغم / ديسيلتر، اتصل بخدمة العملاء.

استيراد وتوزيع:

شركة وربة لتجهيزات الطبية ذ. م. م.
برج الخرافي - مبنى رقم 6
الدور الأول - شارع حمد الصقر
قطعة 14 - القبلة

الهاتف: +965 22323856 / 57

الفاكس: +965 22323856 / 57

البريد الإلكتروني: www.warbamed.com

لاستخدام التشخيص المخبري فقط.

Ascensia (أسينسيا) وشعار Ascensia Diabetes Care (أسينسيا لرعاية السكري) و Contour (كونتور) Microlets (ميكروليت) وشعار No Coding (لا يوجد ترميز) و Second-Chance (سكند تشانس) وشعار Smartlights - Smartcolour و Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Ascensia Diabetes Care Holdings AG مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Apple وشعار Apple علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc.

علامة كلمة وشعارات Bluetooth® Bluetooth® علامات تجارية مسجلة لمملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام للعلامات المماثلة بواسطة Ascensia Diabetes Care هو طبقاً لترخيص.

Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين. ولا ينبغي الاستنتاج أو الاستدلال الضمني على أية علاقة أو تحويل للملكية.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care

90012838
Rev. 05/24

© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة.

جهاز القياس CONTOUR PLUS ELITE الخاص بك

العمل مع تطبيق CONTOUR®DIABETES المجاني.

للتحقق من إتاحة التسجيل الإلكتروني لجهاز القياس، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:

www.diabetes.ascensia.com/registration

لاستخدام التشخيص المخبري فقط.

Apple وشعار Apple علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc.

علامة كلمة وشعارات Bluetooth® Bluetooth® علامات تجارية مسجلة لمملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام للعلامات المماثلة بواسطة Ascensia Diabetes Care هو طبقاً لترخيص.

Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين. ولا ينبغي الاستنتاج أو الاستدلال الضمني على أية علاقة أو تحويل للملكية.

استخدم فقط أشرطة اختبار جولوكون الدم CONTOUR®PLUS.

الدليل المرجعي السريع

ملاحظة: يتم إعداد جهاز القياس مع وقت وتاريخ ونطاق مستهدف محدد مسبقاً. يمكنك تغيير هذه الخصائص من خلال الإعدادات.

ملاحظة: يعمل جهاز قياس CONTOUR PLUS ELITE الخاص بك فقط مع أشرطة اختبار CONTOUR PLUS ومحلول الجودة CONTOUR PLUS.

ملاحظة: راجع دليل المستخدم CONTOUR PLUS ELITE الخاص بك للاطلاع على الاستخدام المخصص لجهاز القياس وقائمة معلومات هامة للسلامة، والتحذيرات، والقيود، والتدابير الوقائية.

ملاحظة: عندما يومض رمز، يمكنك اختياره.

تشغيل وإيقاف تشغيل جهاز القياس

اضغط بشكل متواصل على زر OK لمدة 3 ثوانٍ حتى يتحول جهاز قياسك إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل.

يؤدي إدخال شريط اختبار في جهاز القياس لتشغيل جهاز القياس كذلك.

اضغط الزر OK مرتين عندما يكون جهاز القياس في وضع إيقاف التشغيل، وذلك لتشغيل ضوء منفذ شريط الاختبار الأبيض.

الشاشة الرئيسية تضم الشاشة الرئيسية خيارين: السجل والإعدادات.

اضغط الزر ▼ حتى يصدر الاختيار الذي تريده وميضاً. للاطلاع على قراءاتك والمتوسطات السابقة، اضغط الزر OK بينما يومض السجل. انظر السجل و عرض المتوسطات.

لتغيير الإعدادات، اضغط الزر OK بينما تُصدر الإعدادات وميضاً. انظر الإعدادات.

للحصول على جدول الرموز، انظر شاشة جهاز القياس الخاص بك على الجانب الآخر.

ملاحظة: عندما يومض رمز، يمكنك اختياره.

اختبار طرف الأصبع

راجع نشرة جهاز الوخز الخاص بك للتعليمات التفصيلية حول إعداد جهاز الوخز.

اغسل يديك دائماً بالصابون والماء وجففهما جيداً قبل وبعد الاختبار، أو بعد الإمساك بجهاز القياس أو جهاز الوخز أو أشرطة الاختبار.

تعتبر كل أنظمة قياس جلوكوز الدم خطيرة بيولوجياً. يجب أن يتبع أخصائيو الرعاية الصحية أو الأشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز على عدة مرضى إجراءات مكافحة العدوى المعتمدة من المنشأة الخاصة بهم للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الدم.

جهاز الوخز المزود مخصص للاختبار الذاتي لمرضى واحد. ويجب عدم استعمال الجهاز من قِبل أكثر من شخص واحد بسبب خطر الإصابة بالعدوى.

الأجزاء الصغيرة يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يحتوي هذا الطقم على قطع صغيرة يمكن أن تسبب الاختناق في حال ابتلاعها.

احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال. العديد من أنواع البطاريات سامة. إذا تم ابتلاعها، عليك الاتصال على الفور بمركز مكافحة السموم.

1. إعداد جهاز الوخز. راجع نشرة جهاز الوخز الخاص بك للتعليمات التفصيلية.

2. أدخل طرف المربع الرمادي لشريط اختبار جديد بإحكام في منفذ شريط الاختبار حتى يطلق جهاز القياس صوت صفير.

3. استخدم جهاز الوخز الخاص بك للحصول على قطرة دم من طرف أصبعك.

4. دلك يديك وأصبعك باتجاه موقع الوخز لتشكيل قطرة دم.

5. لامس فوراً طرف شريط الاختبار بقطرة الدم.

تقنية Second-Chance (سكند تشانس) لأخذ العينات

إذا أصدر جهاز القياس صوت صفير مرتين وعرضت الشاشة قطرة دم وامضة مع علامة +، فإن شريط الاختبار ليس فيه دم كاف.

لا ترفع شريط الاختبار. لديك 60 ثانية لوضع المزيد من الدم على شريط الاختبار نفسه.

عند تشغيل علامات الوجبة، يمكنك تمييز القراءات ك صيام قبل الوجبة، أو بعد الوجبة. انظر تشغيل علامات الوجبة.

مؤشر النطاق المستهدف smartLIGHT يعرض جهاز القياس نتيجتك مع الوحدات، الوقت، التاريخ، ومؤشر الهدف:

أعلى من النطاق المستهدف

ضمن النطاق المستهدف

أقل من النطاق المستهدف

يعرض ضوء منفذ شريط الاختبار لوناً مشيراً إلى إذا ما كانت قراءتك أعلى من النطاق المستهدف أو ضمنه أو أقل منه.

السجل

1. لتشغيل جهاز قياسك، اضغط بشكل متواصل على زر OK قرابة 3 ثوانٍ. يومض السجل.

2. لعرض مدخلات السجل الخاص بك، اضغط الزر OK حتى تتمكن من الدخول إلى السجل.

3. للانتقال عبر السجل، اضغط الزر ▲ أو ▼. للانتقال بشكل أسرع عبر المدخلات، اضغط بشكل متواصل على زر ▲ أو ▼.

4. للخروج من السجل والرجوع إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت، اضغط الزر OK.

5. للخروج من المتوسطات والرجوع إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت، اضغط الزر OK.

يمكنك تغيير الإعدادات لكل من:

التاريخ: من خلال تغيير التنسيق والتاريخ.

الوقت: من خلال تغيير التنسيق والوقت.

علامات الوجبة: تشغيل أو إيقاف تشغيل علامات الوجبة.

تقنية Bluetooth اللاسلكية: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية Bluetooth اللاسلكية.

خاصية smartLIGHT: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية smartLIGHT. انظر مؤشر النطاق المستهدف smartLIGHT.

الإعدادات

1. عند يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

2. عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

3. للانتقال خلال المتوسطات الخاصة بك، التي تتراوح بين 7 و14 و30 و90 يوماً، اضغط الزر ▲.

4. للرجوع إلى قراءاتك، اضغط الزر ▼ على 7d Avg (متوسط 7 أيام).

5. للخروج من المتوسطات والرجوع إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت، اضغط الزر OK.

يمكنك تغيير الإعدادات لكل من:

التاريخ: من خلال تغيير التنسيق والتاريخ.

الوقت: من خلال تغيير التنسيق والوقت.

علامات الوجبة: تشغيل أو إيقاف تشغيل علامات الوجبة.

تقنية Bluetooth اللاسلكية: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية Bluetooth اللاسلكية.

خاصية smartLIGHT: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية smartLIGHT. انظر مؤشر النطاق المستهدف smartLIGHT.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

النطاقات المستهدفة

المستهدفة.

الصوت: تشغيل أو إيقاف تشغيل الصوت.

التذكير: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية التذكير.

ملاحظة: لتغيير تاريخ ووقت جهاز القياس، راجع دليل المستخدم.

لتغيير إعدادات جهاز القياس:

1. لتظليل رمز الإعدادات من الشاشة الرئيسية، اضغط الزر ▼.

2. عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

3. للانتقال خلال المتوسطات الخاصة بك، التي تتراوح بين 7 و14 و30 و90 يوماً، اضغط الزر ▲.

4. للرجوع إلى قراءاتك، اضغط الزر ▼ على 7d Avg (متوسط 7 أيام).

5. للخروج من المتوسطات والرجوع إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت، اضغط الزر OK.

يمكنك تغيير الإعدادات لكل من:

التاريخ: من خلال تغيير التنسيق والتاريخ.

الوقت: من خلال تغيير التنسيق والوقت.

علامات الوجبة: تشغيل أو إيقاف تشغيل علامات الوجبة.

تقنية Bluetooth اللاسلكية: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية Bluetooth اللاسلكية.

خاصية smartLIGHT: تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية smartLIGHT. انظر مؤشر النطاق المستهدف smartLIGHT.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.


ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

ملاحظة: عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

الإعدادات (تابع)

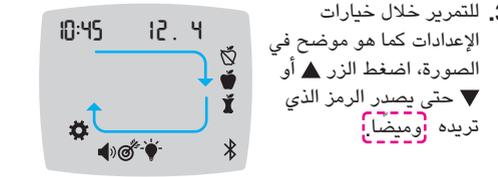

3. للتمرير خلال خيارات الإعدادات كما هو موضح في الصورة، اضغط الزر ▲ أو ▼ حتى يصدر الرمز الذي تريده **وميضًا**.

4. اضغط الزر OK لتحديد الرمز الواضع.

5. لتعديل الإعداد، اضغط الزر ▲ أو ▼.

يمكنك تحويل الإعداد إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل، أو تغيير القيمة.

6. لقبول التغيير والعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط الزر OK.

للخروج من الإعدادات والرجوع إلى الشاشة الرئيسية:

1. اضغط الزر ▲ أو ▼ حتى يصدر رمز الإعدادات ضوءًا وميضًا.
2. اضغط الزر OK.

إذا كنت في إعداد مثل التاريخ وتريد الخروج منه، اضغط الزر OK بشكل متواصل حتى ترجع إلى الشاشة الرئيسية.

ضبط النطاق المستهدف الكلي



تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك قبل إعداد أي نطاقات مستهدفة في جهاز القياس الخاص بك أو في برنامج Ascensia Diabetes Care متوافق.

1. لتظليل رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الزر ▼.

2. عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

3. للتمرير إلى رمز النطاق المستهدف، اضغط الزر ▲ أو ▼.

4. لضبط الهدف المنخفض الكلي الواضع، اضغط الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط الزر OK.

5. لضبط الهدف المرتفع الكلي الواضع، اضغط الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط الزر OK.

تشغيل علامات الوجبة

1. لتظليل رمز الإعدادات، اضغط الزر OK من الشاشة الرئيسية، اضغط الزر ▼.

2. عندما يومض رمز الإعدادات، اضغط الزر OK لدخول الإعدادات.

3. للتمرير إلى رموز علامة الوجبة، اضغط الزر ▲ أو ▼.

4. عندما تكون رموز علامة الوجبة وامضة، اضغط الزر OK.

5. اضغط الزر ▲ أو ▼ حتى يصدر زر On (التشغيل) وميضًا، ثم اضغط الزر OK.

ملاحظة: مع وضع علامات الوجبة في وضع التشغيل، يمكنك ضبط قبل الوجبة و بعد الوجبة للنطاقات المستهدفة (انظر دليل مستخدم CONTOUR PLUS ELITE). يمكنك أيضا ضبط التذكير.

تحويل خاصية التذكير إلى وضع التشغيل

عندما تكون علامات الوجبة في وضع التشغيل، يمكنك ضبط خاصية التذكير لاختبار نسبة جلوكوز الدم بعد تمييز قراءة بأنها قبل الوجبة. إذا كانت علامات الوجبة في وضع إيقاف التشغيل، انظر تشغيل علامات الوجبة في هذا الدليل.

1. لتظليل رمز الإعدادات، اضغط الزر OK من الشاشة الرئيسية، اضغط الزر ▼.

2. عندما يصدر رمز الإعدادات وميضًا، اضغط الزر OK للدخول إلى الإعدادات.

3. للتمرير إلى رمز التذكير، اضغط الزر ▲ أو ▼.

4. عندما يومض رمز التذكير، اضغط الزر OK.

5. اضغط الزر ▲ أو ▼ حتى يصدر زر On (التشغيل) وميضًا، ثم اضغط الزر OK.

اختيار علامة وجبة أثناء اختبار جلوكوز الدم



ملاحظة: ينبغي عليك إجراء اختبار جلوكوز الدم قبل أن يمكنك اختيار علامة الوجبة. لا يمكنك اختيار علامة وجبة في الإعدادات.

1. افحص جلوكوز الدم. انظر اختبار طرف الأصبع في هذا الدليل.

2. لا ترفع شريط الاختبار حتى تختار علامة وجبة.

3. تومض علامة الوجبة على شاشة نتيجة جلوكوز الدم.

4. لضبط التذكير، اضغط الزر OK.

5. إذا كانت علامة الوجبة الوامضة هي التي تريدها، اضغط الزر OK.

6. لاختيار علامة وجبة مختلفة، اضغط الزر ▲ أو ▼.

7. عندما تكون علامة الوجبة التي تريدها وامضة، اضغط الزر OK.

ملاحظة: إذا لم تختَر علامة الوجبة خلال 3 دقائق، سينطفئ جهاز القياس. يتم حفظ قراءة جلوكوز الدم في السجل بدون علامة الوجبة.

ضبط التذكير

1. تأكد من وضع خاصية التذكير في وضع التشغيل في الإعدادات.

2. ضع علامة على قراءة جلوكوز الدم كقراءة قبل الوجبة ثم اضغط الزر OK.

3. للتمرير من 2 ساعة إلى 0.5 ساعة بفواصل نصف ساعة، اضغط الزر ▲ أو ▼.

4. لضبط التذكير، اضغط الزر OK.

5. تعود الشاشة إلى القراءة قبل الوجبة. يعرض رمز التذكير للتأكيد على ضبط التذكير.

6. إذا كانت علامة الوجبة الوامضة هي التي تريدها، اضغط الزر OK.

7. لاختيار علامة وجبة مختلفة، اضغط الزر ▲ أو ▼.

8. عندما تكون علامة الوجبة التي تريدها وامضة، اضغط الزر OK.

نتائج LO (منخفض)

إذا أصدر الجهاز صوت صغير مرتين وعرض شاشة LO (منخفض)، فإن قراءة جلوكوز الدم أقل من 0.6 مليمول/لتر.



اتبع النصيحة الطبية فورًا. اتصل بأخصائي الرعاية الصحية لديك.

نتائج HI (مرتفع)

إذا أصدر الجهاز صوت صغير مرة واحدة وعرض شاشة HI (مرتفع)، فإن قراءة جلوكوز الدم أعلى من 33.3 مليمول/لتر.



1. قم بغسل يديك وتجفيفهما جيدًا.

2. أعد الاختبار بشريط اختبار جديد.

3. إذا كانت النتائج لا تزال أعلى من 33.3 مليمول/لتر، اتبع النصيحة الطبية فورًا.

4. لإيقاف جهاز القياس الخاص بك عن العمل، قم بإزالة شريط الاختبار.

تحذير

- تخلص دائمًا من أشرطة الاختبار وإبر الوخز المستخدمة كنفايات طبية أو كما يوصي به أخصائي الرعاية الصحية لديك.
- يجب أن يتبع أخصائيو الرعاية الصحية متطلبات التخلص من مخلفات المواد الخطرة بيولوجيًا الخاصة بمنشأتهم.

الرمز	ماذا يعني
	السجل الخاص بك
	إعدادات جهاز القياس
	مؤشر النطاق المستهدف smartLIGHT (أصفر=أعلى من النطاق المستهدف؛ أخضر=ضمن النطاق المستهدف؛ أحمر=أقل من النطاق المستهدف)
	إعداد نطاق مستهدف أو نطاق مستهدف
	نتيجة اختبار جلوكوز الدم أعلى من النطاق المستهدف
	نتيجة اختبار جلوكوز الدم ضمن النطاق المستهدف
	نتيجة اختبار جلوكوز الدم أقل من النطاق المستهدف

الرمز	ماذا يعني
	علامة الصيام: تستخدم عند الاختبار بعد الصيام (لا طعام أو شراب لمدة 8 ساعات باستثناء الماء أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية)
	علامة قبل الوجبة: تستخدم عند الاختبار خلال 1 ساعة قبل الوجبة
	علامة بعد الوجبة: تستخدم عند الاختبار خلال 2 ساعة بعد اللقمة الأولى من الوجبة
	اختيار بدون علامة وجبة
	خاصية التذكير
	خاصية الصوت

الرمز	ماذا يعني
	يشير إلى أن إعداد تقنية Bluetooth اللاسلكية في وضع التشغيل؛ يمكن لجهاز القياس التواصل مع جهاز متنقل
	يشير إلى خطأ في جهاز القياس
	البطاريات منخفضة وينبغي تغييرها
	المتوسطات 7d Avg، و14، و30 و90 يومًا
	العدد الإجمالي لقراءات نسبة جلوكوز الدم المستخدم لحساب المتوسطات
	نتيجة اختبار محلولة الجودة
	أضف المزيد من الدم إلى نفس شريط الاختبار

يمكنك تطبيق CONTOUR DIABETES بنقل النتائج من جهاز القياس الخاص بك إلى هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي المتوافق. للاطلاع على التعليمات والخصائص انظر دليل المستخدم.